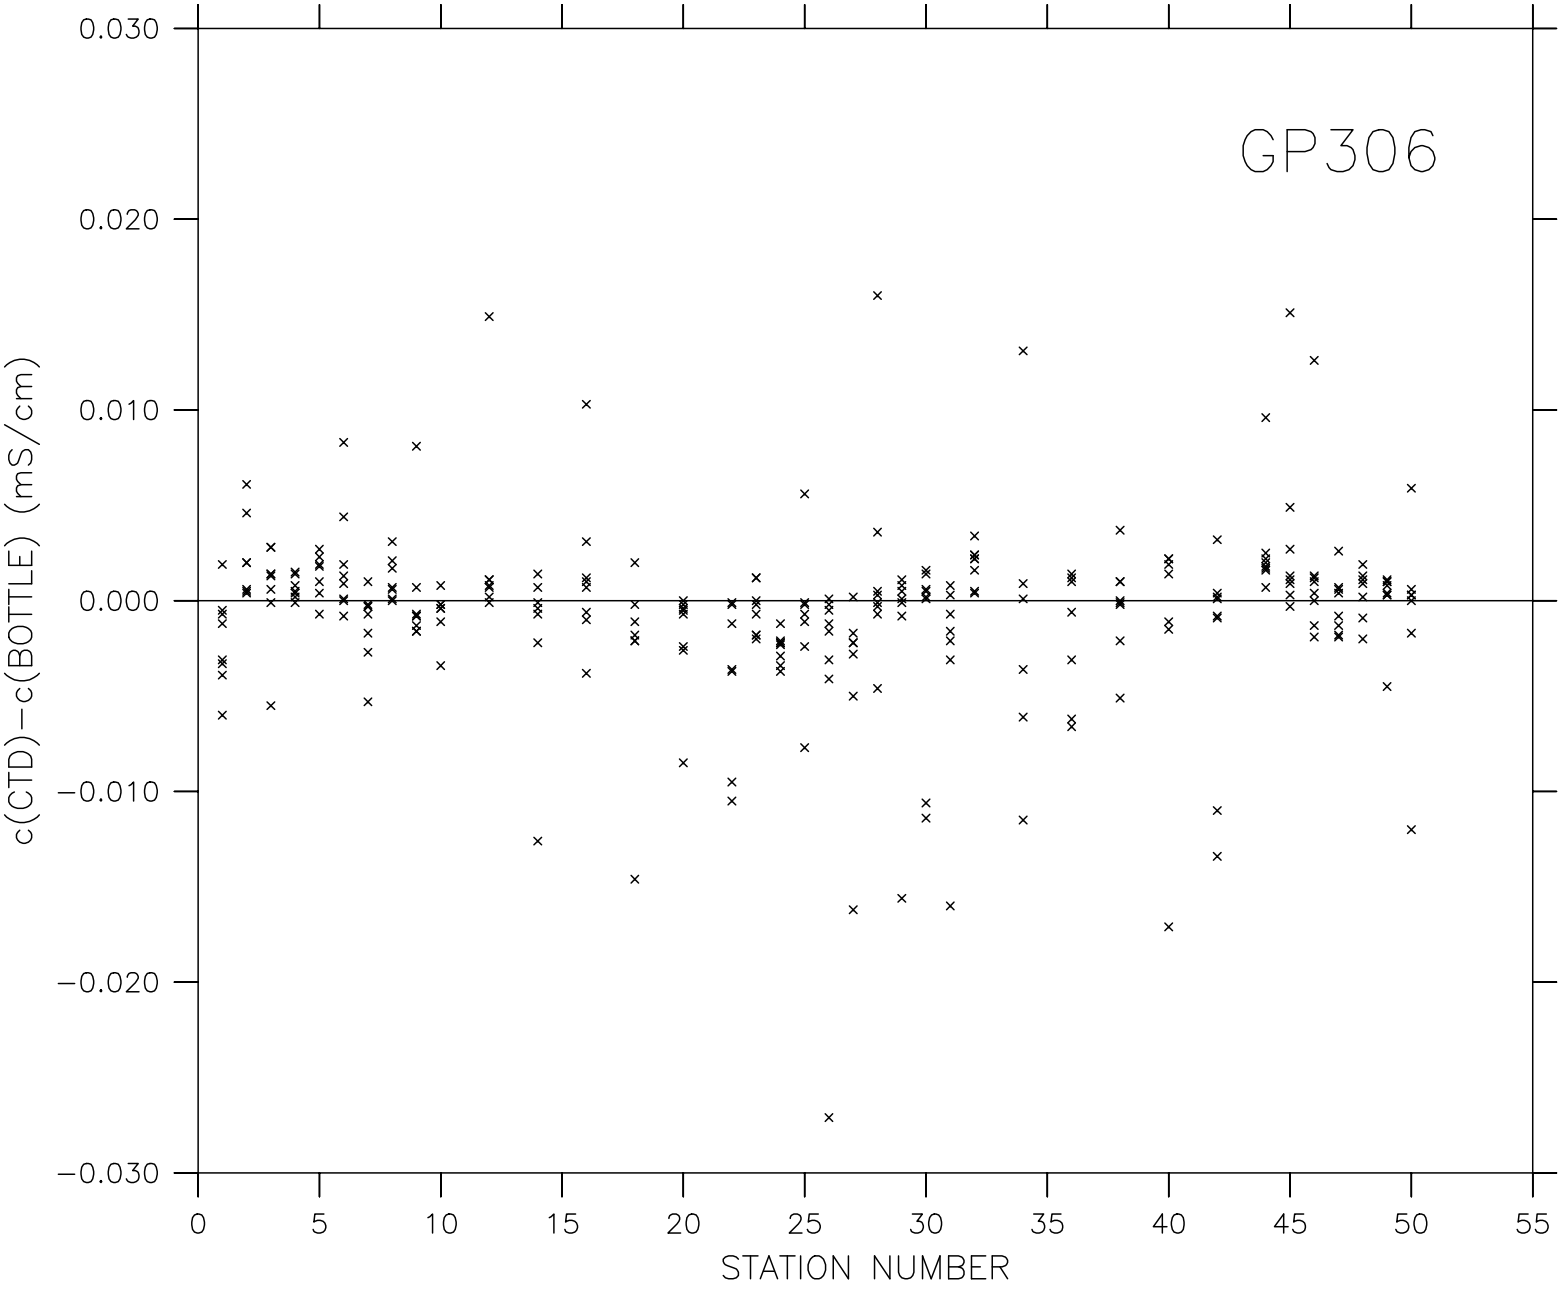
GP306
0.030
0.020
0.010
0.000
−0.010
−0.020
−0.030
c(CTD)−c(BOTTLE) (mS/cm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
STATION NUMBER