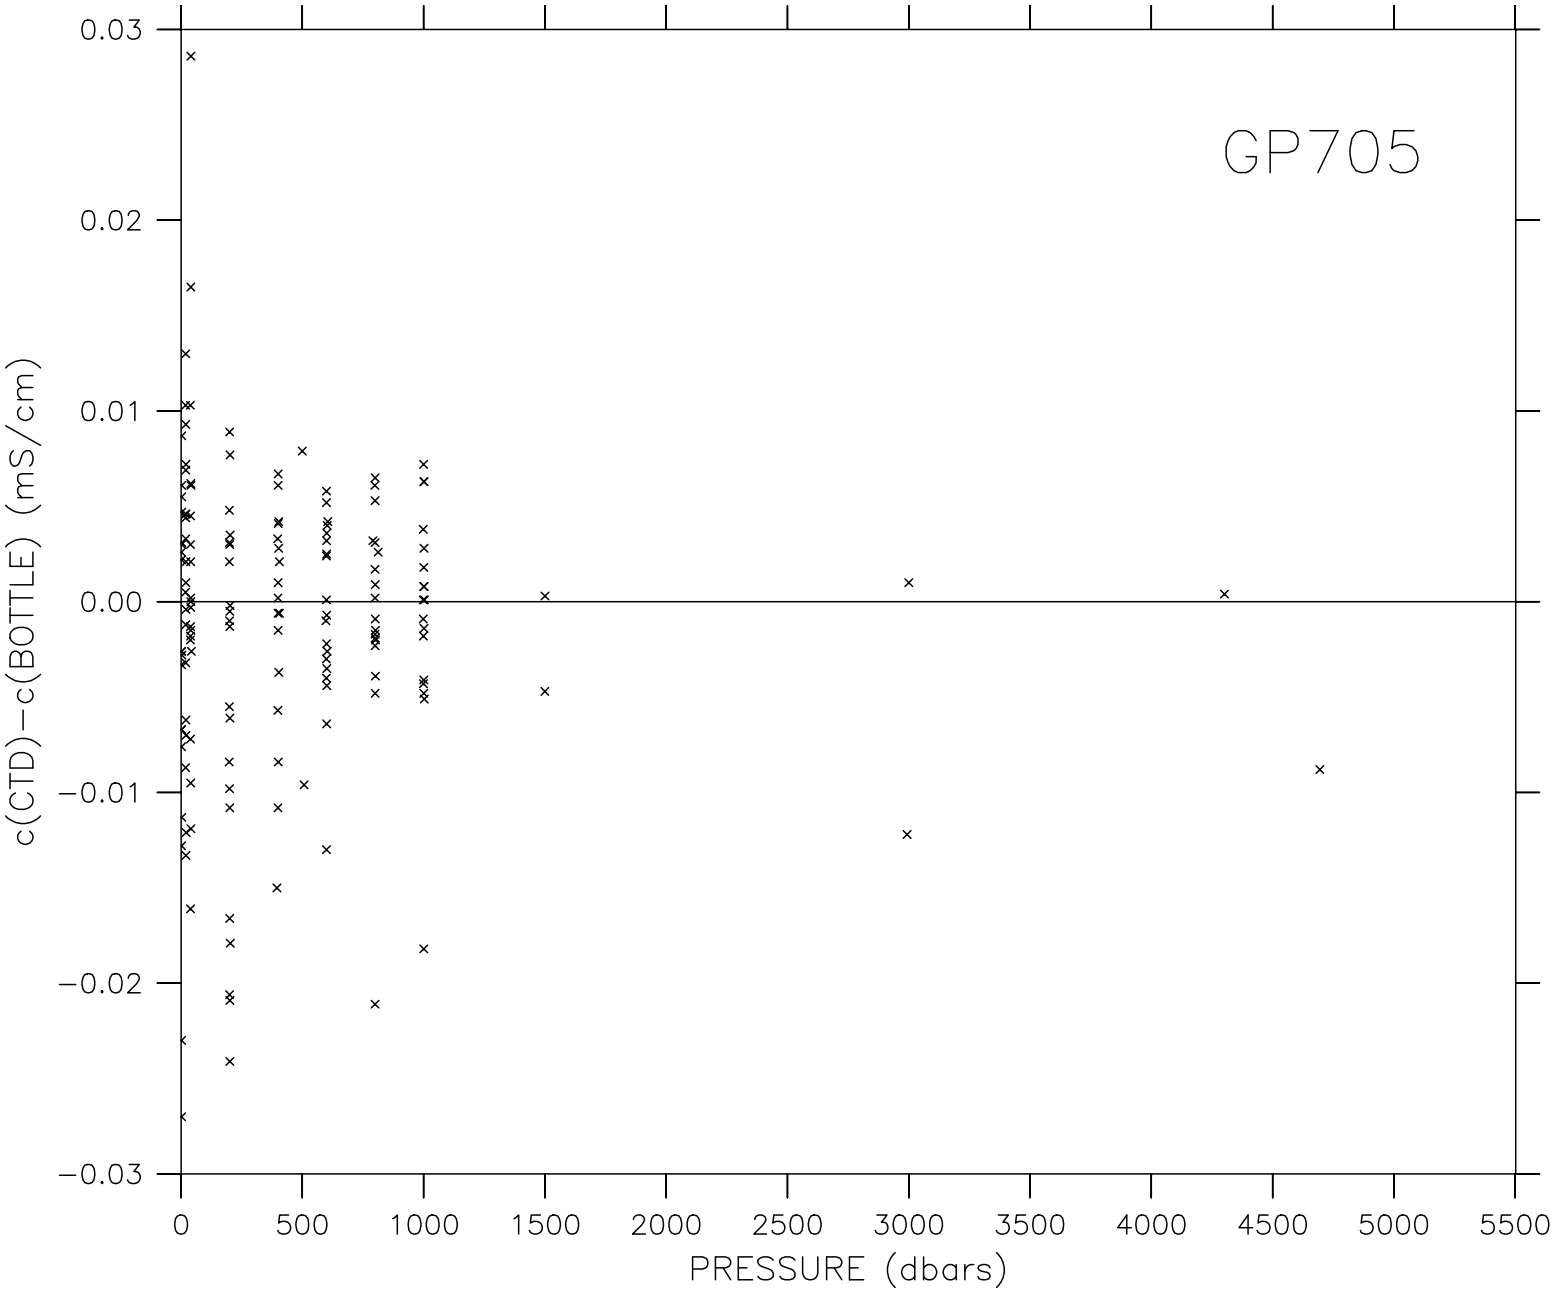
GP705
c(CTD)−c(BOTTLE) (mS/cm)
PRESSURE (dbars)
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500